LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Montre connectée




Référence : TEC615
Version : 1.6
Langue : Français

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

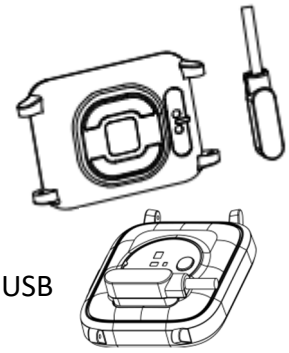

Attention

Avant d'utiliser le bracelet pour la première fois, il doit être chargé et activé. Utilisez le chargeur magnétique pour attirer la pointe métallique à l'arrière du bracelet. L'autre extrémité du chargeur peut être connectée à la tête de chargement USB ou à l'interface USB de l'ordinateur.


1. N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur à 2A. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures.
2. Ne pas charger après que l'appareil ait été endommagé par l'eau
3. Ceci est un produit de surveillance électronique, les données reçues ne peuvent pas être utilisées comme base médicale.
4. Conseil de test de pression artérielle :
a) Gardez votre corps détendu et immobile pendant le test.
b) Gardez l'appareil à la même hauteur que votre cœur et ne parlez pas pendant le test.
5. Un environnement de charge de plus de 50 degrés peut provoquer une surchauffe et une déformation de l'équipement.
6. Cet appareil utilise une batterie intégrée. Il est interdit de démonter. Veuillez ne pas laisser tomber, heurter, serrer, percer ou couper.
7. Lorsque la batterie est cassée ou fuit, veuillez éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lorsque la situation se produit, veuillez ne pas toucher la zone de contact et rincer immédiatement à l'eau.

Avertissement

Ce produit n’est pas un appareil médical. Les montres et leurs applications ne doivent pas être utilisées pour un diagnostic, un traitement, en prévention de maladies ou infections. Pour changer vos habitudes telle que l’exercice et le sommeil, assurez-vous de consulter une professionnel médical pour éviter tout problème de santé. Livoo se réserve le droit de modifier et améliorer n’importe laquelle des fonctions décrites dans ce manuel sans préavis et de mettre à jour continuellement le contenu du produit. Tous les contenus correspondent au produit réel.

Notice d’utilisation

DESCRIPTIF DU PRODUIT




Bouton d’alimentation ON/OFF

Ecran tactile

Capteur photoélectrique

Contacts de charge



Capteur de température

TELECHARGEMENT ET APPAIRAGE

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer.
2. Scannez le code QR suivant et installez l'application ou téléchargez l'application «Gloryfit» depuis l'App Store ou Google play ou Android, en recherchant «Gloryfit».

Android iOS Google Play

Compatible avec les smartphones : Android 4.4 et supérieur, Bluetooth 4.0, et les smartphones IOS 8.0 et supérieur.


- ✓ Étape 1: Ouvrez le mobile pour configurer les informations personnelles
- ✓ Étape 2: passez à la page «Appareil» et cliquez sur l'appareil de liaison
- ✓ Étape 3: Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils scannés
- ✓ Étape 4: liaison terminée

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation


INTERFACE DE FONCTIONS

A partir de de l’écran principal, appuyez brièvement sur le bouton tactile pour basculer vers les différentes interfaces.

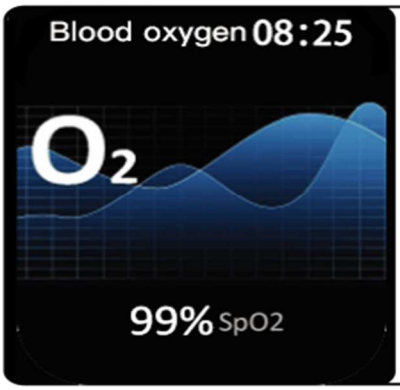

Interface d'oxygène sanguin

Passez à l'interface de test d'oxygène sanguin pour accéder à la détection en temps réel de l'oxygène sanguin.
Les données de surveillance peuvent être mises à jour de manière synchrone vers l'APP avec un rapport de test.

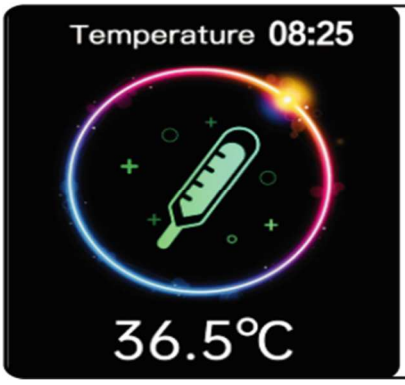

Interface température corporelle

Passez à l'interface de test de température pour entrer en mode détection de température en temps réel, les données de surveillance peuvent être mises à jour de manière synchrone vers l'APP avec un rapport de test.

Remarque : lors du test de la température corporelle, le capteur température doit être en contact total avec la peau (testée après 10 minutes de port). Le test de température corporelle peut être affecté par la différence de température de l'environnement. Elle ne sert que de contrôle.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer à un équipement professionnel médical et au diagnostic du médecin




Interface de mouvement

Consultez le nombre de pas que vous faites, la distance que vous parcourez et les calories que vous brûlez à tout moment de la journée. Vous pouvez vérifier vos données de mouvement dans l'APP en temps voulu.


LIVOO
Feel good moments

Notice d'utilisation

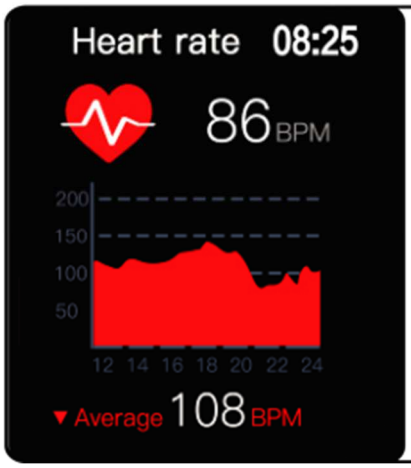

Rythme cardiaque

Passez à l'interface de test de rythme cardiaque pour entrer la détection de la fréquence cardiaque en temps réel.
Les données de surveillance peuvent être mises à jour de manière synchrone vers l'APP avec un rapport de test.

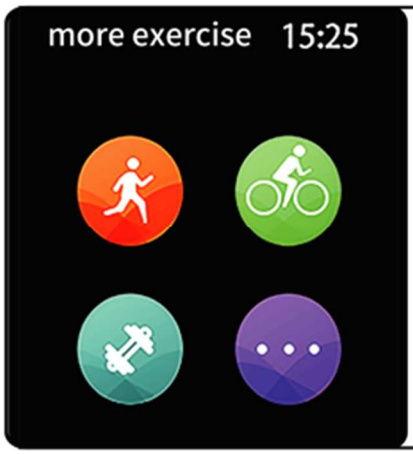

Tension artérielle

Passez à l'interface de la tension artérielle pour surveiller en temps réel la tension artérielle. Les données de surveillance peuvent être mises à jour de manière synchrone vers l'APP avec un rapport de test.



Multi-sport

Cliquez sur l'icône multi-motion pour accéder à la sélection du mode sport, avec une variété de modes de mouvement à choisir.



Fonction de surveillance sommeil

Votre montre peut enregistrer et afficher la quantité totale de sommeil que vous avez eu la nuit dernière, ainsi que la durée de votre sommeil profond et de votre sommeil léger. Une analyse plus détaillée et des enregistrements de données peuvent être consultés dans le client. Remarque: les données relatives au sommeil ne sont disponibles que lorsque vous portez le bracelet pour vous endormir.


LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation




Information météo

La page météo affichera les informations actuelles sur la météo et la qualité de l'air. Les informations météorologiques doivent être connectées au téléphone de l’utilisateur pour être mises à jour. Si la connexion est interrompue pendant une longue période, les informations météorologiques ne seront pas mises à jour.
Remarque: il n'y a pas d'interface météo avant que le bracelet ne soit connecté à l'application. Après la connexion de l'application, le téléphone doit ouvrir la localisation.

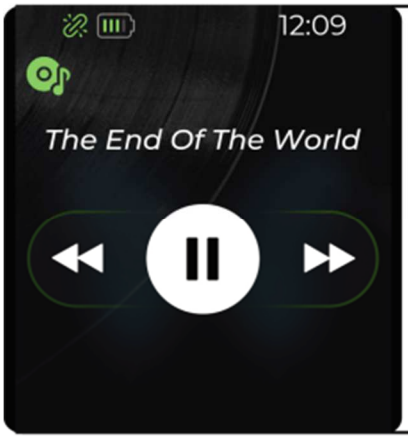


Musique

Lorsqu'elle est connectée, la montre peut contrôler le lecteur de musique du téléphone.

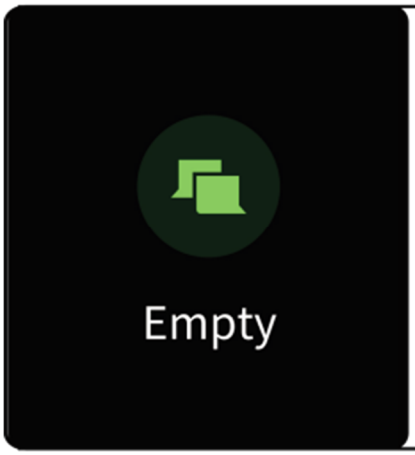

Information

La montre peut recevoir des notifications push qui s'affichent sur le téléphone, et vous pouvez désactiver les éléments push dans l’interface. Balayez vers le haut dans l'interface principale pour accéder à l'univers de la messagerie

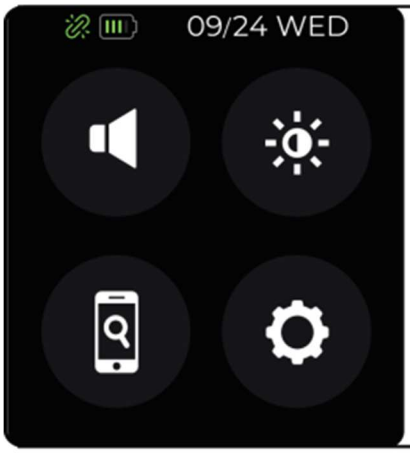

Autres fonctions

Faire glisser vers le bas dans l'interface principale pour accéder à la zone des fonctions de raccourci, vous pouvez sélectionner les paramètres "trouver le téléphone portable", "ne pas déranger", "réglage de la luminosité" et d'autres options, cliquez sur l'icône pour accéder à la fonction correspondante.




Interface principale/écran principal

Appuyez et maintenez l’interface principale, défilez l’écran vers gauche ou droit pour changer le l’affichage principal. Vous pouvez personnaliser le cadran en choisissant vos propres photos.

Autres options

Appuyez pour accéder à la page de menu inférieur pour plus d'opérations.



Interface principale /écran principal

Appuyez sur l’icône ci-dessous pour changer le cadran du bracelet.



Page de réglage de la luminosité

Sur la page de réglage de la luminosité, cliquez sur le + ou - pour régler la luminosité de l'écran.



Information



MAC ID, informations sur la version de la montre.

Page d'arrêt

Cliquez sur l’icône arrêt et confirmer le choix arrêt pour éteindre la montre.



Restaurer la page
Cliquer sur l'icône ci-dessous pour restaurer la montre



PRÉCAUTIONS

1. N'utilisez pas d'adaptateur avec un courant supérieur à 2A. Le temps de charge est d'environ 2 à 3 heures
2. Ne pas charger après que l'appareil a été endommagé par l'eau
3. Ceci est un produit de surveillance électronique, les données reçues ne peuvent pas être utilisées comme base médicale.
4. Conseil de test de pression artérielle :
a) Gardez votre corps détendu et immobile pendant le test.
b) Gardez l'appareil à la même hauteur que votre cœur et ne parlez pas pendant le test.

Avertissement : ce produit n'est pas un appareil médical. Le bracelet et l'APP ne sont pas destinés à faire un diagnostic, un traitement ou prévenir des maladies. Si vous voulez changer vos habitudes telles que le sport et le sommeil, vous devez d'abord consulter un professionnel médical pour éviter des blessures graves ou la mort. Nous nous réservons le droit de modifier et d'améliorer toutes les fonctions décrites dans ce manuel d'instructions, de mette à jour en permanence ce produit sans préavis. Veuillez-vous référer au produit réel.

DECLARATION EU DE CONFORMITE

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Equipment radioélectrique

Montre connectée
TEC615 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio standard(s) en application :
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)

Compatibilité électromagnétique standards en application :
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Niveau de sécurité d’équipement informatique standards en application :
EN 62368-1 :2020

SAR : EN 50663:2017

Mundolsheim, le 23/08/2021



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

LIVOO
Feel good moments

User manual

Smartwatch



Reference: TEC615
Version: 1.6
Language: English


WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

User manual

Thank you for buying our LIVOO product. We take great care in design, ergonomics and ease of use of our products. We hope that this product will give you complete satisfaction.

This instruction manual is also available on our website www.livoo.fr

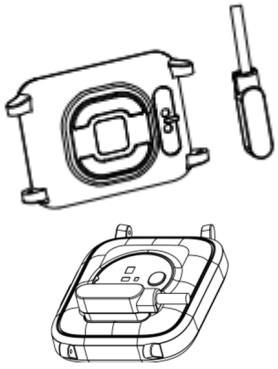

Attention

Before using the bracelet for the first time, it needs to be charged and activated. Use the equipped magnetic charger to attract to the metal point on the back of the bracelet. The other end of the charger can be connected to the USB charging head or computer USB interface.

1. Do not use an adapter with a current over 2A. Charging time is around 2~3 hours.
2. Do not charge after the device was water damaged.
3. This is an electronic monitoring product, data received from it cannot be used as medical basis.
4. Blood pressure testing tip ：

a) Keep your body relaxed and still while testing.

b) Keep device at the same height as your heart, and don’t talk while you are testing.

5. A charging environment of more than 50 degrees may cause overheating and deformation of the equipment.
6. This device uses built-in battery. It is forbidden to disassemble by itself. Please do not drop, collide, squeeze, puncture or cut.
7. When the battery is broken or leaking, please avoid contact with eyes and skin. When the situation occurs, please do not touch the contact area and rinse immediately with water.


Warning:

This product is not a medical device. Watches and their applications should not be used for diagnosis, treatment, or prevention of diseases or illnesses. To change your habits such as exercise and sleep, be sure to consult a qualified medical professional to avoid serious injury. We reserve the right to modify and improve any of the functions described in this manual without prior notice and continuously update the contents of the product. All contents are subject to the actual product.

LIVOO
Feel good moments

User manual

COMPONENT INTRODUCTION



Power bouton ON/OFF

Touch the display

Photoelectric sensor

Charging contact



Temperature Sensor

DOWNLOADING & PARING

1. Long press the power button to turn on.
2. Scan the following QR code and install the APP or download “GloryFit” App from App store or Google play, Android by searching for “Gloryfit”.

Android iOS Google Play

Compatibility System: Android 4.4 and above; IOS 8.0 and above. Bluetooth 4.0 is supported.

- ✓ Step 1: Open the mobile to set up personal information
- ✓ Step 2: Swith to the “Device” page and click on the binding device
- ✓ Step 3 : Click on your device in the list of scanned devices
- ✓ Step 4 : Binding completed


FUNCTIONS INTERFACE

From the main screen, briefly press the touch button to switch to the different interfaces.



Blood Oxygen

Switch the blood oxygen test interface to enter the blood oxygen real-time detection, the monitoring data can be updated to the APP synchronously, and there's a test report.

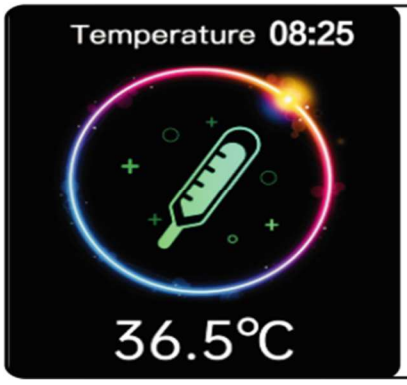

Body Temperature


Switch to the temperature test interface to get access to real-time temperature detection, the monitoring data can be updated to the APP synchronously, and there's a test report.

Note: When testing body temperature, the temperature sensor must be in full contact with the skin (tested after 10 minutes of wearing). The body temperature test will be affected by the temperature difference of the environment, it only serves as a warning reminder.
For details, please refer to medical professional equipment and doctor diagnosis.




State

See the number of steps you walk, the distance you walk, and calories you burn at any time of the day. You can check your motion data in the APP in a timely manner.

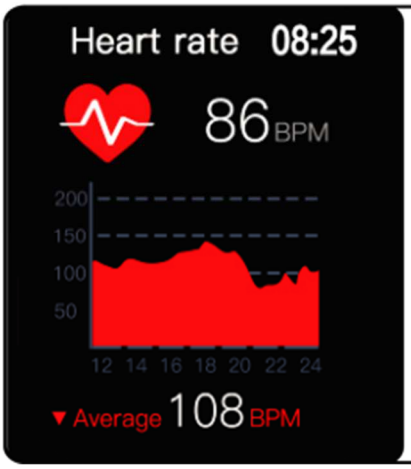

HeartRate

Switch to the heart rate test interface for real-time heart rate monitoring, the data can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

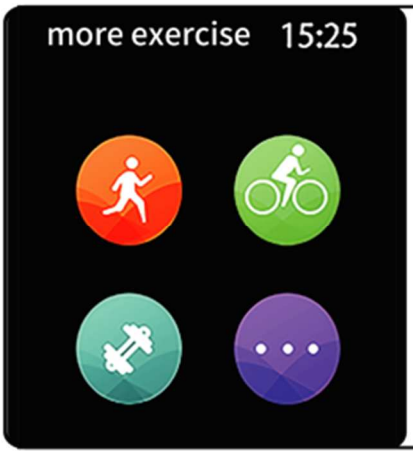

Blood Pressure

Switch to the blood pressure interface for real-time monitoring of blood pressure, the data can be updated to the APP synchronously, and there is a report.



Multi-sport

Click on the multi-motion icon to enter the Sport Mode selection, with a variety of motion modes to choose from.



Sleep

Your watch can record and show the total amount of sleep you had last night, as well as the length of your deep sleep and light sleep. More detailed analysis and data records can be viewed in the client.


Note: Only when wearing the bracelet to fall asleep will there be sleep data.



Weather


The weather page will display the current weather and air quality information. The weather information needs to be connected to the client to obtain data. If the connection is disconnected for a long time, the weather information will not be updated.

Note: There is no weather interface before the bracelet is connected to the APP. After connecting the APP there is a weather inter face, the phone needs to open the positioning.

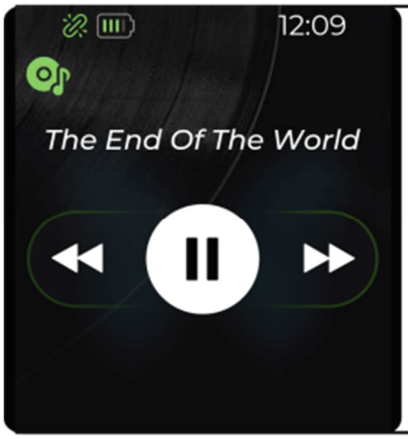


Music

While connected, the watch can control the phone music player.

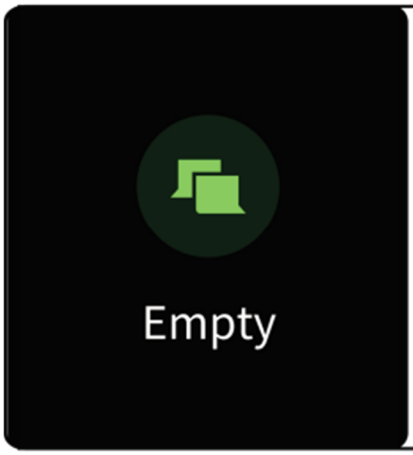

Information

The watch can receive notification pushes that displays on the phone, and you can set push items to turn off in the client. Swipe up in the main interface to get to the messaging world.

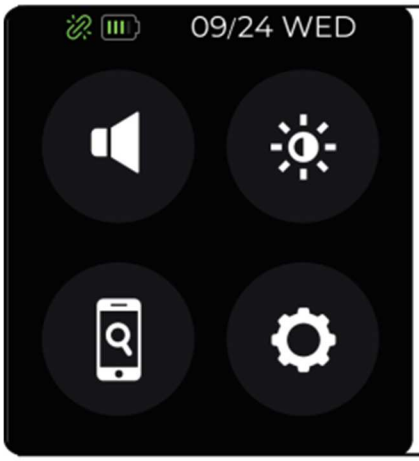

Other features

Swipe down in the main interface to enter the shortcut function boundary, you can select the “find mobile phone”, “don’t disturb on”, “brightness adjustment” settings and other options, click on the icon to enter the corresponding function.



The dial switches
Press and hold the dial page, go to the dial switch, or switch the dial on the settings page. You can customize the dial by choosing your own pictures.

Other functions
Press to enter the lower menu page for more operations.



Brightness adjustment page
On the brightness adjustment page, click the “+” or “-” to adjust the screen brightness.



Information
MAC ID, watch firmware version information.



Restore page
On the bracelet restore page, press the touch key to restore the bracelet.



Shutdown page
On the shutdown page, press the touch button to shut off the appliance.



PRECAUTIONS

1. Do not use an adapter with a current over 2A. Charging time is around 2~3 hours
2. Do not charge after the device was water damaged
3. This is an electronic monitoring product, data received from it cannot be used as medical basis.
4. Blood pressure testing tip ：

a) Keep your body relaxed and still while testing.
b) Keep device at the same height as your heart, and don’t talk while you are testing.

Warning: this product is not a medical device. The Smart band and its applications should not be used in diagnosis, treatment for as a preventive treatment for diseases and sickness. Please consult medical professionals before changing exercise habit or sleep habit to avoid serious injuries. The manufacturer reserves the right to modify and improve any functions description in this user guide and continuous update of the new content without further notice. This user guide is for reference only, the smart band for selling is subject to the final product.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Herewith declare under our sole responsibility, that the radio equipment

Smartwatch
TEC615 (Frequency range 2402MHz~2480MHz)

Fulfils the essential requirements of the Directive 2014/53/UE

The following standards were applied:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)

EMC:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Health and Safety:
EN 62368-1 :2020

SAR : EN 50663:2017

Mundolsheim, 23/08/2021



Correct disposal of the unit
(Electrical and Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries)

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Non contractual illustration
- Product information is subject to change without prior notice.

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones

Reloj inteligente



Referencia: TEC615
Versión: 1.6
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Atención



Antes de usar el brazalete por primera vez, es necesario cargarlo y activarlo.
Utilice el cargador magnético equipado para atraer a la punta metálica de la parte posterior del brazalete. El otro extremo del cargador puede conectarse al cabezal de carga USB o a la interfaz USB de una computadora.


1. No use un adaptador de más de 2 A de corriente. El tiempo de carga es de, aproximadamente, 2 a 3 horas.
2. No cargue el dispositivo si se dañó con agua.
3. Este es un producto de monitorización electrónico, los datos obtenidos de él no se pueden utilizar como fundamento médico.
4. Sugerencia para la prueba de presión sanguínea :
a) Mantenga el cuerpo relajado y quieto mientras realiza la prueba.
b) Mantenga el dispositivo a la altura del corazón y no hable mientras esté realizando la prueba.
5. Un ambiente de carga de más de 50 grados puede causar sobrecalentamiento y deformación del equipo.
6. Este dispositivo utiliza una batería incorporada. Está prohibido desmontarla por cuenta propia. No deje la caer, golpee, apriete, perfore o corte.
7. Si la batería se rompe o presenta fugas, evite el contacto con los ojos y la piel. Si dicha situación ocurre, no toque el área de contacto y enjuáguela inmediatamente con agua.

Advertencia:

Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben utilizarse para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades o afecciones. Para cambiar sus hábitos, por ejemplo, de ejercicio y sueño, asegúrese de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso y de actualizar continuamente el contenido del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN AL COMPONENTE




Bouton de la energía

Toque la pantalla

Fotoeléctrico sensor

Contacto de carga



Sensor de temperatura

DESCARGA Y EMPAREJAMIENTO

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo.
2. Escanee el siguiente código QR e instale la aplicación "Gloryfit" o descárguela de App Store o de Google Play, Android.

Android iOS Google Play


Sistemas compatibles: Android 4.4 y superior; IOS 8.0 y superior. Admite Bluetooth 4.0.

- ✓ Paso 1: Abra el móvil para configurar la información personal
- ✓ Paso 2: Pase a la página "Dispositivo" y haga clic en el dispositivo que desea conectar
- ✓ Paso 3: En su dispositivo, haga clic en la lista de dispositivos escaneados
- ✓ Paso 4: La conexión se ha completado

Manual de instrucciones


FUNCIÓN DE LA INTERFAZ

Desde la pantalla principal, pulse brevemente el botón táctil para cambiar a las diferentes interfaces.

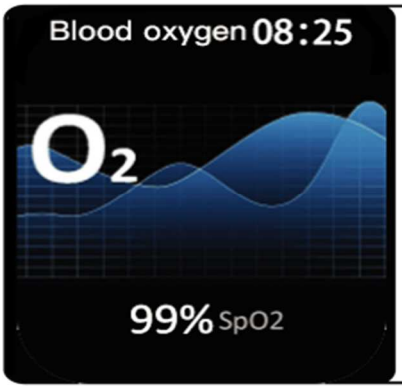

Oxígeno en sangre

Cambie la interfaz de la prueba de oxígeno en sangre para entrar en la detección de oxígeno en sangre en tiempo real, los datos de monitoreo pueden ser actualizados a la APP de forma sincronizada, y hay un informe de la prueba.

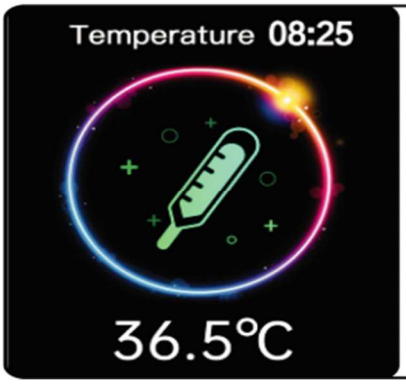

Temperatura corporal

Cambia a la interfaz de prueba de temperatura para acceder a la detección de temperatura en tiempo real, los datos de monitoreo pueden ser actualizados a la APP de forma sincronizada, y hay un informe de prueba.

Nota: Cuando se comprueba la temperatura corporal, el sensor de temperatura debe estar en pleno contacto con la piel (se comprueba después de 10 minutos de uso). La prueba de temperatura corporal se verá afectada por la diferencia de temperatura del entorno, sólo sirve como recordatorio de advertencia. Para más detalles, consulte el equipo profesional médico y el diagnóstico del médico.




Estado

Consulta el número de pasos que das, la distancia que recorres y las calorías que quemas en cualquier momento del día. Puedes consultar tus datos de movimiento en la APP de forma puntual.



Ritmo cardíaco

Cambia a la interfaz de prueba de la frecuencia cardíaca para controlar la frecuencia cardíaca en tiempo real, los datos se pueden actualizar en la APP de forma sincronizada, y hay un informe de prueba.

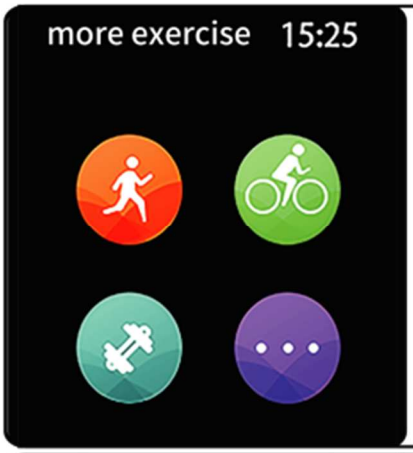


Presión arterial

Cambie a la interfaz de la presión arterial para el control en tiempo real de la presión arterial, los datos se pueden actualizar a la APP de forma sincronizada, y hay un informe.



Multi-deporte

Pulsa el icono de multimovimiento para entrar en la selección del modo deportivo, con una variedad de modos de movimiento para elegir.

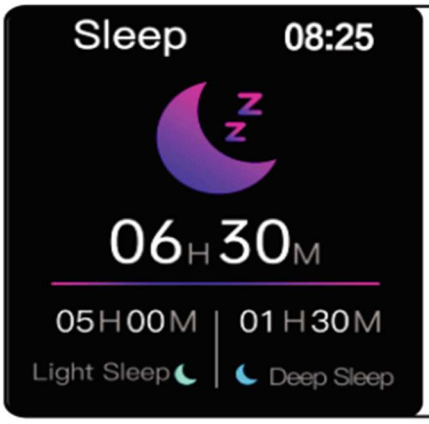

Sueño

Tu reloj puede registrar y mostrar la cantidad total de sueño que tuviste anoche, así como la duración del sueño profundo y del sueño ligero. Se pueden ver análisis más detallados y registros de datos en el cliente.


Nota: Sólo cuando se lleve la pulsera para dormir habrá datos del sueño.



El tiempo


La página del tiempo mostrará la información meteorológica actual y la calidad del aire. La información meteorológica necesita estar conectada al cliente para obtener los datos. Si la conexión se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará.

Nota: No hay interfaz meteorológica antes de que la pulsera se conecte a la APP. Después de conectar la APP hay una intercara meteorológica, el teléfono necesita abrir el posicionamiento.

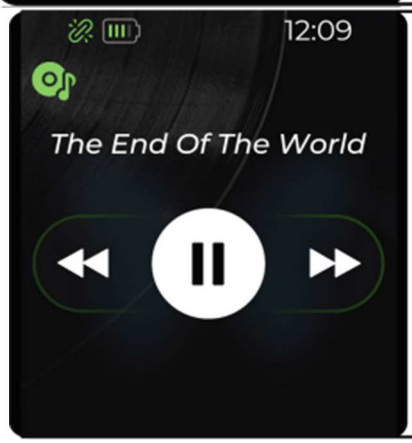


Música

Mientras está conectado, el reloj puede controlar el reproductor de música del teléfono.

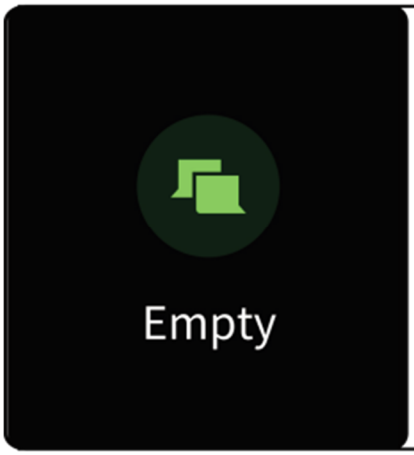

Información

El reloj puede recibir las notificaciones push que se muestran en el teléfono, y puedes configurar los elementos push para desactivarlos en el cliente. Desliza el dedo hacia arriba en la interfaz principal para llegar al mundo de la mensajería.

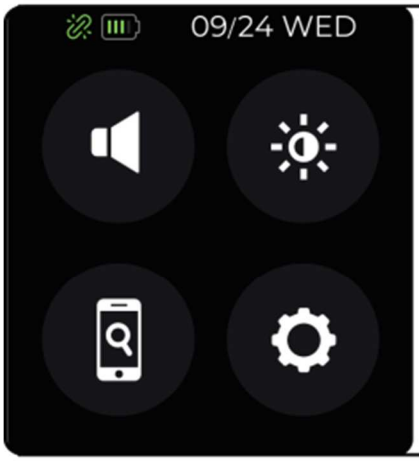

Otras funciones

Desliza el dedo hacia abajo en la interfaz principal para entrar en el límite de la función de acceso directo, puedes seleccionar la configuración de "encontrar el teléfono móvil", "no molestar", "ajustar el brillo" y otras opciones, haz clic en el icono para entrar en la función correspondiente..



Los interruptores de dial

Mantén pulsada la página del dial, ve al interruptor del dial o cambia el dial en la página de ajustes. Puedes personalizar el dial eligiendo tus propias imágenes.

Otras funciones
Pulse para acceder a la página inferior del menú para realizar más operaciones.



Página de ajuste del brillo
En la página de ajuste del brillo, haz clic en "+" o "-" para ajustar el brillo de la pantalla.



Información
MAC ID, información de la versión del firmware del reloj.



Página de restauración
En la página de restauración de la pulsera, pulse la tecla táctil para restaurar la pulsera.



Página de apagado
En la página de apagado, pulse el botón táctil para apagar el aparato.



PRECAUCIONES

1. No use un adaptador de más de 2 A de corriente. El tiempo de carga es de, aproximadamente, 2 a 3 horas
2. No cargue el dispositivo si se dañó con agua.
3. Este es un producto de monitorización electrónico, los datos obtenidos de él no se pueden utilizar como fundamento médico.
4. Sugerencia para la prueba de presión sanguínea:
a) Mantenga el cuerpo relajado y quieto mientras realiza la prueba.
b) Mantenga el dispositivo a la altura del corazón y no hable mientras esté realizando la prueba.

Advertencia: este producto no es un dispositivo médico. La banda inteligente y sus aplicaciones no deben utilizarse en el diagnóstico, tratamiento o como tratamiento preventivo de enfermedades y dolencias. Consulte a profesionales médicos antes de cambiar sus hábitos de ejercicio o de sueño para evitar lesiones graves. El fabricante se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquier descripción de las funciones en esta guía del usuario y actualizar contenidos nuevos de forma continua sin previo aviso. Esta guía de usuario está destinada a utilizarse únicamente como referencia. La banda inteligente para la venta está sujeta a las condiciones del producto final.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

por el presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el equipo de radio

Reloj inteligente para deportes
TEC615 (rango de frecuencia 2402MHz~2480MHz)

cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

Se aplicaron las siguientes normas:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)

EMC:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Salud y seguridad:

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones

EN 62368-1 :2020

SAR: EN 50663:2017

Mundolsheim, 23/08/2021



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Smartwatch



Referenz: TEC615
Version: 1.6
Sprache: Deutsch

WWW.LIVOO.FR


LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Achtung



Das Armband muss vor dem Erstgebrauch aufgeladen und aktiviert werden. Verwenden Sie das mit dem Magneten ausgestattete Ladegerät, indem Sie es an den Metallkontakten auf der Rückseite des Armbandes anbringen. Das andere Ende des Ladegerätes kann an den USB-Ladeanschluss oder an die USB-Schnittstelle des Computers angeschlossen werden.



1. Verwenden Sie kein Netzteil mit einer Ausgangsleistung über 2 A. Der Ladevorgang dauert ca. 2-3 Stunden.
2. Kein Ladevorgang ausführen, nachdem das Gerät durch Wasser beschädigt wurde.
3. Dies ist ein elektronisches Kontrollgerät, darüber bezogene Daten dürfen nicht zur medizinischen Diagnose verwendet werden.
4. Tipps für die Blutdruckkontrolle ：
a) Halten Sie Ihren Körper entspannt und bewegungslos während der Messung.
b) Positionieren Sie Gerät auf Herzhöhe und sprechen Sie während der Blutdruckkontrolle nicht.
5. Eine Ladeumgebung von mehr als 50 Grad Celsius kann zu einer Überhitzung und Deformation des Geräts führen.
6. Dieses Gerät verwendet einen eingebauten Akku. Das eigenständige Zerlegen des Geräts ist verboten. Bitte nicht fallen lassen, Stoßeinwirkungen aussetzen, quetschen, durchstechen oder zerschneiden.
7. Wenn der Akku defekt oder undicht ist, vermeiden Sie bitte den Kontakt mit den Augen und der Haut. Falls eine solche Situation eintritt, berühren Sie bitte nicht die Kontaktstelle am Körper und spülen Sie diese sofort mit Wasser ab.


Warnhinweis:


Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Uhren und ihre Anwendungen sollten nicht für die Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Leiden oder Erkrankungen verwendet werden. Für die Umstellung Ihrer Gewohnheiten, wie körperliche Bewegung und Schlaf, stellen Sie sicher, dass Sie einen Facharzt konsultieren, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Wir behalten uns das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen ohne Vorankündigung zu ändern und zu verbessern sowie kontinuierlich die Bestandteile des Produkts zu aktualisieren. Beziehen Sie sich für alle Inhalte auf das tatsächliche Produkt.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

KOMPONENTENTEILE





HERUNTERLADEN & KOPPELN

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
2. Scannen Sie den folgenden QR-Code und installieren Sie die APP oder laden Sie die App "GloryFit" aus dem App-Store oder von Google play, Android herunter, indem Sie nach "Gloryfit" suchen.

Android iOS Google Play


Kompatible Systeme: Android 4.4 und höher, iOS 8.0 und höher. Es wird Bluetooth 4.0 unterstützt.

- ✓ Schritt 1: Öffnen Sie die App, um Ihre persönlichen Informationen einzugeben
- ✓ Schritt 2: Wechseln Sie zur Seite „Gerät“ und klicken Sie auf Gerät binden
- ✓ Schritt 3: Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät
- ✓ Schritt 4: Bindung abgeschlossen

Bedienungsanleitung


FUNKTIONSMENÜ

Drücken Sie auf dem Hauptbildschirm kurz auf die Berührungstaste, um zu den verschiedenen Schnittstellen zu wechseln.

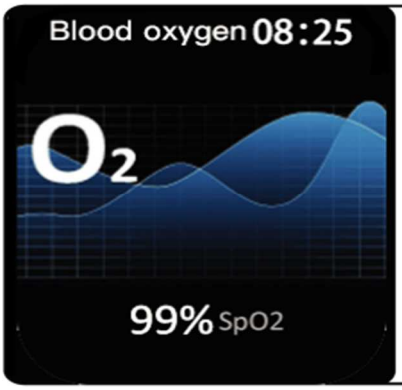

Blutsauerstoff

Schalten Sie die Blutsauerstoff-Test-Schnittstelle, um die Blutsauerstoff-Echtzeit-Erkennung, die Überwachungsdaten können aktualisiert werden, um die APP synchron, und es gibt einen Testbericht.

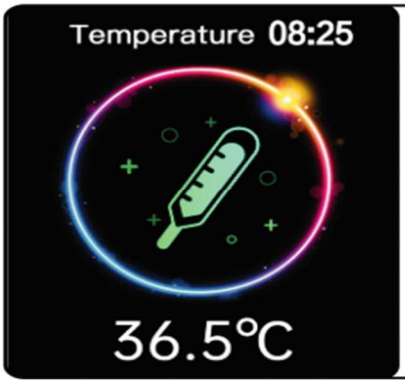

Körpertemperatur

Wechseln Sie zum Temperaturtest-Interface, um Zugang zur Echtzeit-Temperaturerfassung zu erhalten. Die Überwachungsdaten können synchron zur APP aktualisiert werden, und es gibt einen Testbericht.

Hinweis: Beim Testen der Körpertemperatur muss der Temperatursensor in vollem Kontakt mit der Haut sein (Test nach 10 Minuten Tragen). Der Körpertemperaturtest wird durch den Temperaturunterschied der Umgebung beeinflusst, er dient nur als Warnhinweis.
Weitere Informationen finden Sie in der medizinischen Fachausrüstung und der ärztlichen Diagnose.




Stand

Sehen Sie die Anzahl der Schritte, die Sie gehen, die Entfernung, die Sie gehen, und die Kalorien, die Sie verbrennen, zu jeder Zeit des Tages. Sie können Ihre Bewegungsdaten zeitnah in der APP überprüfen.



HeartRate

Switch to the heart rate test interface for real-time heart rate monitoring, the data can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

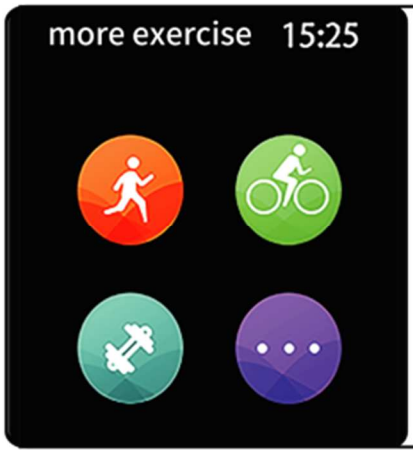

Blood Pressure

Switch to the blood pressure interface for real-time monitoring of blood pressure, the data can be updated to the APP synchronously, and there is a report.



Multi-sport

Click on the multi-motion icon to enter the Sport Mode selection, with a variety of motion modes to choose from.



Sleep

Your watch can record and show the total amount of sleep you had last night, as well as the length of your deep sleep and light sleep. More detailed analysis and data records can be viewed in the client.


Note: Only when wearing the bracelet to fall asleep will there be sleep data.



Wetter


Auf der Wetterseite werden die aktuellen Wetter- und Luftqualitätsinformationen angezeigt. Die Wetterinformationen müssen mit dem Client verbunden sein, um Daten zu erhalten. Wenn die Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.

Hinweis: Bevor das Armband mit der APP verbunden ist, gibt es keine Wetterschnittstelle. Nach der Verbindung mit der APP gibt es ein Wetter-Interface, das Telefon muss die Positionierung öffnen.

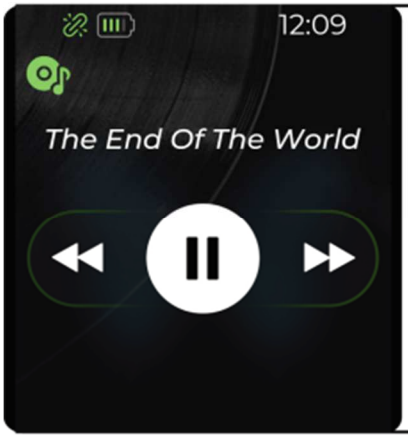


Musik

Während die Uhr verbunden ist, kann sie den Musikplayer des Telefons steuern.

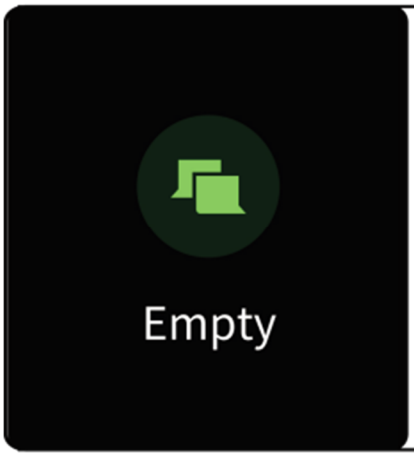

Informationen

Die Uhr kann Push-Benachrichtigungen empfangen, die auf dem Telefon angezeigt werden, und Sie können Push-Elemente auf dem Client deaktivieren. Wischen Sie auf der Hauptschnittstelle nach oben, um die Nachrichtenwelt zu öffnen.

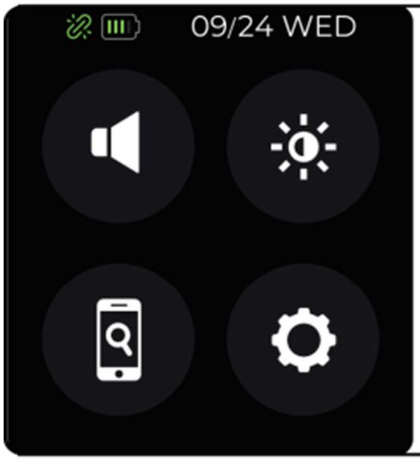

Andere Funktionen


Wischen Sie auf der Hauptschnittstelle nach unten, um die Verknüpfungsfunktion zu öffnen. Sie können die Einstellungen "Handy finden", "Nicht stören", "Helligkeit einstellen" und andere Optionen auswählen.



Die Wählschalter

Halten Sie die Zifferblattseite gedrückt, gehen Sie zum Zifferblattschalter, oder schalten Sie das Zifferblatt auf der Einstellungsseite um. Sie können das Zifferblatt durch die Auswahl eigener Bilder anpassen.


Andere Funktionen
Drücken Sie , um die untere Menüseite für weitere Funktionen aufzurufen.



Seite zur Einstellung der Helligkeit
Klicken Sie auf der Seite zur Einstellung der Helligkeit auf "+" oder "-", um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.



Informatie
MAC ID, informatie over de firmwareversie van het horloge.



Seite Wiederherstellen
Drücken Sie auf der Seite für die Wiederherstellung des Armbands die Berührungstaste, um das Armband wiederherzustellen.



Seite zum Ausschalten
Drücken Sie auf der Seite "Ausschalten" auf die Schaltfläche , um das Gerät auszuschalten.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie kein Netzteil mit einer Ausgangsleistung über 2 A. Der Ladevorgang dauert ca. 2-3 Stunden.
2. Kein Ladevorgang ausführen, nachdem das Gerät durch Wasser beschädigt wurde.
3. Dies ist ein elektronisches Kontrollgerät, darüber bezogene Daten dürfen nicht zur medizinischen Diagnose verwendet werden.
4. Tipps für die Blutdruckkontrolle ：
a) Halten Sie Ihren Körper entspannt und bewegungslos während der Kontrolle.
b) Bringen Sie Gerät auf Herzhöhe und sprechen Sie während der Blutdruckkontrolle nicht.

Warnung: Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Das intelligente Armband und seine Anwendungen dürfen nicht zur Diagnose und vorbeugenden Behandlung für Leiden und Erkrankungen verwendet werden. Bitte konsultieren Sie medizinische Fachkräfte, bevor Sie Ihre Trainings- oder Schlafgewohnheiten ändern, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Funktionsbeschreibung in diesem Benutzerhandbuch und die kontinuierliche Aktualisierung der neuen Inhalte ohne weitere Ankündigung zu ändern und zu verbessern. Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz, das intelligente Armband als endgültiges Produkt ist maßgeblich.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Funkausrüstung der

Smartwatch
TEC615 (Frequenzbereich 2402MHz~2480MHz)

die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/UE erfüllt.

Folgende Normen wurden angewandt:

Funk:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)

EMV:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Gesundheit und Sicherheit:

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

EN 62368-1 :2020

Spezifische Absorptionsrate: EN 50663:2017

Mundolsheim, 23/08/2021



Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

LIVOO
Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Smartwatch




Riferimento: TEC615
Versione: 1.6
Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manuale di Istruzioni


Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.



Questa manuele di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Attenzione

Prima di utilizzare il bracciale per la prima volta, è necessario caricarlo e attivarlo.
Utilizzare il caricabatterie magnetico in dotazione per attrarre il punto metallico sul retro del bracciale. L'altra estremità del caricatore può essere collegata alla testa di ricarica USB o all'interfaccia USB del computer.



1. Non utilizzare un adattatore con una corrente superiore a 2A. Il tempo di ricarica è di circa 2 - 3 ore.
2. Non caricare dopo che il dispositivo è stato danneggiato dall'acqua.
3. Questo è un prodotto di monitoraggio elettronico, i dati ricevuti non possono essere utilizzati come base medica.
4. Suggerimento per il test della pressione sanguigna:
a) Mantenere il corpo rilassato e fermo durante il test.
b) Mantenere il dispositivo alla stessa altezza del cuore e non parlare durante il test.
5. Un ambiente di carica superiore a 50 gradi può causare il surriscaldamento e la deformazione dell'apparecchiatura.
6. Questo dispositivo utilizza una batteria incorporata. È vietato smontarlo da solo. Si prega di non far cadere, non far collidere, non spremere, non forare e non tagliare.
7. Se la batteria è rotta o perde, si prega di evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Se si verifica ciò, si prega di non toccare l'area di contatto e sciacquare immediatamente con acqua.


Attenzione:

Questo prodotto non è un dispositivo medico. Gli orologi e le loro applicazioni non devono essere utilizzati per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione di malattie o patologie. Per modificare le vostre abitudini, come l'esercizio fisico e il sonno, assicuratevi di consultare un professionista medico qualificato per evitare gravi lesioni. Ci riserviamo il diritto di modificare e migliorare senza preavviso qualsiasi funzione descritta in questo manuale e di aggiornare continuamente il contenuto del prodotto. Tutti i contenuti sono soggetti al prodotto vero e proprio.

LIVOO
Feel good moments

Manuale di Istruzioni

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI




Bouton di alimentazione ON/OFF

Toccare il display

Fotoelettrico sensore

Contatto di carica



Sensore di temperatura

DOWNLOAD E ACCOPPIAMENTO

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere.
2. Scannerizzare il seguente codice QR e installare l'APP o scaricare "GloryFit" App da App store o Google play, Android cercando "Gloryfit".

Android

iOS


Google Play

Sistemi compatibili: Android 4.4 e superiore; IOS 8.0 e superiore. Bluetooth 4.0 è supportato.

- ✓ Step 1: Aprire il cellulare per impostare le informazioni personali
- ✓ Step 2: Passare alla pagina "Apparecchio" e cliccare su accoppiamento dispositivo
- ✓ Step 3 : Cliccare sul proprio dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati
- ✓ Step 4 : Accoppiamento completato


FUNZIONI INTERFACCIA

Dalla schermata principale, premere brevemente il pulsante a sfioramento per passare alle diverse interfacce.

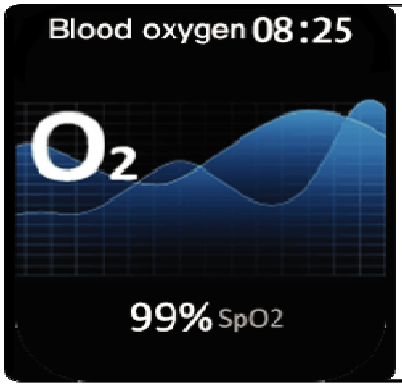

Ossigeno del sangue

Commuta l'interfaccia del test dell'ossigeno del sangue per entrare nel rilevamento in tempo reale dell'ossigeno del sangue, i dati di monitoraggio possono essere aggiornati all'APP in modo sincrono, e c'è un rapporto di test.

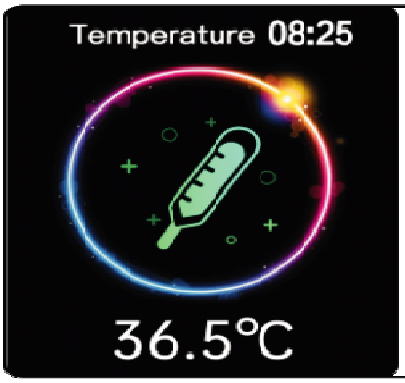

Temperatura del corpo


Passa all'interfaccia del test della temperatura per avere accesso al rilevamento della temperatura in tempo reale, i dati di monitoraggio possono essere aggiornati all'APP in modo sincrono, e c'è un rapporto di test.

Nota: Quando si testa la temperatura corporea, il sensore di temperatura deve essere in pieno contatto con la pelle (testato dopo 10 minuti di utilizzo). Il test della temperatura corporea sarà influenzato dalla differenza di temperatura dell'ambiente, serve solo come un promemoria di avvertimento.
Per i dettagli, si prega di fare riferimento alle attrezzature mediche professionali e alla diagnosi del medico.




Stato

Vedi il numero di passi che fai, la distanza che percorri e le calorie che bruci in qualsiasi momento della giornata. Puoi controllare i tuoi dati di movimento nell'APP in modo tempestivo.

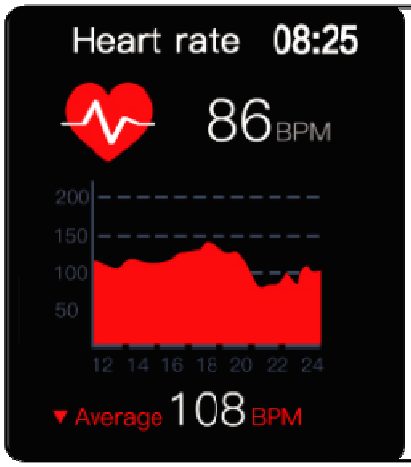

Frequenza cardiaca

Passa all'interfaccia del test della frequenza cardiaca per il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, i dati possono essere aggiornati all'APP sincronicamente, e c'è un rapporto di test.

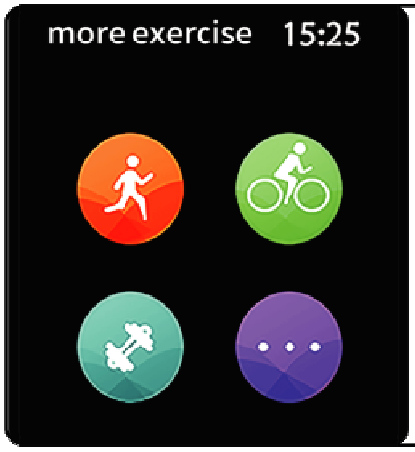


Pressione sanguigna

Passa all'interfaccia della pressione sanguigna per il monitoraggio in tempo reale della pressione sanguigna, i dati possono essere aggiornati all'APP sincronicamente, e c'è un rapporto.



Multi-sport

Clicca sull'icona multi-motion per entrare nella selezione della modalità Sport, con una varietà di modalità di movimento tra cui scegliere.

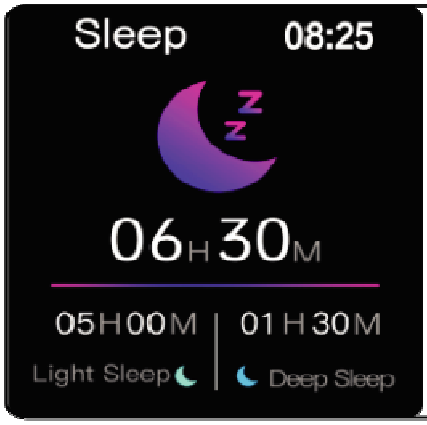

Sonno

Il tuo orologio può registrare e mostrare la quantità totale di sonno che hai avuto la scorsa notte, così come la durata del sonno profondo e del sonno leggero. Analisi più dettagliate e registrazioni di dati possono essere visualizzate nel client.


Nota: solo quando indossi il bracciale per addormentarti ci saranno dati sul sonno.



Meteo


La pagina del meteo mostrerà le informazioni sul tempo attuale e sulla qualità dell'aria. Le informazioni meteo devono essere connesse al client per ottenere i dati. Se la connessione è scollegata per un lungo periodo, le informazioni meteo non saranno aggiornate.

Nota: Non c'è un'interfaccia meteo prima che il braccialetto sia collegato all'APP. Dopo aver collegato l'APP c'è un'interfaccia meteo, il telefono deve aprire il posizionamento.

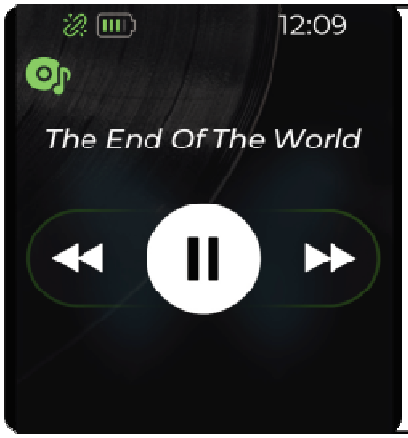


Musica

Mentre è collegato, l'orologio può controllare il lettore musicale del telefono.

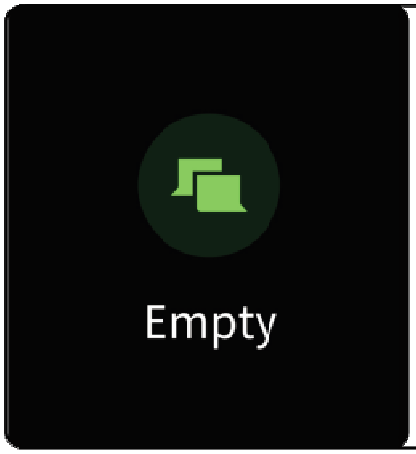

Informazioni

L'orologio può ricevere notifiche push che vengono visualizzate sul telefono, ed è possibile impostare gli elementi push da disattivare nel client. Scorri verso l'alto nell'interfaccia principale per accedere al mondo della messaggistica.

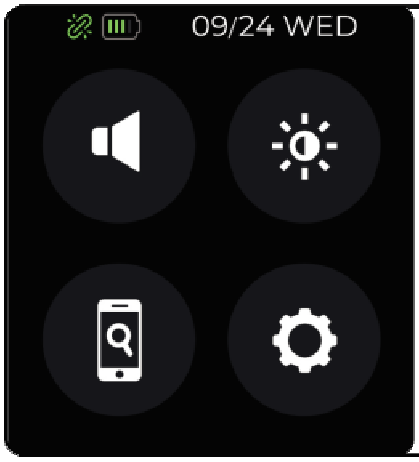

Altre funzioni

Scorri verso il basso nell'interfaccia principale per entrare nel limite della funzione di scorciatoia, puoi selezionare le impostazioni "trova telefono cellulare", "non disturbare", "regolazione della luminosità" e altre opzioni, clicca sull'icona per entrare nella funzione corrispondente.



I selettori

Premi e tieni premuta la pagina del quadrante, vai all'interruttore del quadrante, o cambia il quadrante nella pagina delle impostazioni. Puoi personalizzare il selettore scegliendo le tue immagini.


Altre funzioni
Premere per entrare nella pagina inferiore del menu per altre operazioni.



Pagina di regolazione della luminosità
Nella pagina di regolazione della luminosità, clicca su "+" o "-" per regolare la luminosità dello schermo.



Informazioni
MAC ID, informazioni sulla versione del firmware dell'orologio.



Pagina di ripristino
Nella pagina di ripristino del braccialetto, premi il tasto per ripristinare il braccialetto.



Pagina di spegnimento
Nella pagina di spegnimento, premere il pulsante a sfioramento per spegnere l'apparecchio.



PRECAUZIONI

1. Non utilizzare un adattatore con una corrente superiore a 2A. Il tempo di ricarica è di circa 2 - 3 ore.
2. Non caricare dopo che il dispositivo è stato danneggiato dall'acqua.
3. Si tratta di un prodotto di monitoraggio elettronico, i dati ricevuti da esso non possono essere utilizzati come base medica.
4. Suggerimento per il test della pressione sanguigna:
a) Mantenere il corpo rilassato e fermo durante il test.
b) Mantenere il dispositivo alla stessa altezza del cuore e non parlare durante il test.

Attenzione: questo prodotto non è un dispositivo medico. La fascia smart e le sue applicazioni non dovrebbero essere utilizzate per la diagnosi, il trattamento per la prevenzione delle malattie e delle patologie. Si prega di consultare i medici prima di cambiare l'abitudine all'esercizio fisico o al sonno per evitare gravi lesioni. Il produttore si riserva il diritto di modificare e migliorare senza ulteriore preavviso qualsiasi descrizione delle funzioni in questo manuale d'uso e il continuo aggiornamento dei nuovi contenuti. Questa guida utente è solo per riferimento, la fascia smart per la vendita è soggetta al prodotto finale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Con il presente documento dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio
Smartwatch
TEC615 (gamma di frequenza 2402MHz~2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati gli standard seguenti:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07
EMC:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Salute e sicurezza:
EN 62368-1 :2020

SAR : EN 50663:2017

Mundolsheim, 23/08/2021



Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrução

Relógio inteligente



Referência: TEC615
Versão: 1.6
Idioma: Portuguese

WWW.LIVOO.FR


LIVOO
Feel good moments

Manual de instrução


Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Atenção



Antes de usar o bracelete pela primeira vez, ele precisa ser carregado e ativado. Use o carregador magnético equipado para atrair o ponto metálico na traseira do bracelete. A outra extremidade do carregador pode ser conectada na cabeça de carregamento USB ou interface USB do computador.




1. Não use um adaptador com uma corrente sobre 2A. Tempo de carregamento é cerca de 2~3 horas.
2. Não carregue após o dispositivo tiver sido danificado pela água.
3. Este é um produto de monitoramento eletrônico, os dados recebidos dele não podem ser usados como base médica.
4. Dica de teste de pressão sanguínea:
a) Mantenha seu corpo relaxado e ainda parado enquanto testando.
b) Mantenha o dispositivo na mesma altura que o seu coração e não fale enquanto você está testando.
5. Um ambiente de carregamento de mais de 50 graus pode causar sobreaquecimento e deformação do equipamento.
6. Este dispositivo usa bateria integrada. É proibido desmontar você mesmo. Não derrube, colida, aperte, perfure ou corte.
7. Quando a bateria estiver quebrada ou vazando, evite que entre em contato com os olhos e a pele. Quando a situação ocorrer, não toque na área de contato e enxague imediatamente com água.

Advertência:

Este produto não é um dispositivo médico. Os relógios e seus aplicativos não devem ser usados para diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças ou enfermidades. Para mudar seus hábitos como exercício e sono, certifique-se de consultar um profissional médico qualificado para evitar lesão séria. Reservamos o direito de modificar e aprimorar quaisquer das funções descritas neste manual sem aviso prévio e atualizar continuamente os conteúdos do produto. Todos os conteúdos estão sujeitos ao produto real.

Manual de instrução

INTRODUÇÃO DE COMPONENTE




Botão Ligar/Desligar / Touche de

Táctil Ecran

Sensor fotoeléctrico

Contactos de encarregados



Sensor de temperatura

BAIXANDO E EMPARELHANDO

1. Pressione longamente o botão de alimentação para ligar.
2. Digitalizar o seguinte código QR e instalar a aplicação ou descarregar a aplicação "Gloryfit" da App Store ou Google play ou Android, procurando por "Gloryfit".

Android

iOS

Google Play

Sistema de compatibilidade: Android 4.4 e acima; IOS 8.0 e acima. Bluetooth 4.0 é suportado.

- ✓ Etapa 1: Abra o dispositivo móvel para configurar as informações pessoais
- ✓ Etapa 2: Mude para a página “Dispositivo” e clique no dispositivo vinculativo
- ✓ Etapa 3: Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos analisados
- ✓ Etapa 4: Vinculação concluída


INTERFACE DE FUNÇÕES

A partir do ecrã principal, premir brevemente o botão de toque para mudar para as diferentes interfaces.



Oxigénio sanguíneo

Mudar a interface do teste de oxigénio no sangue para entrar na detecção de oxigénio no sangue em tempo real, os dados de monitorização podem ser actualizados para o APP de forma síncrona, e há um relatório de teste.

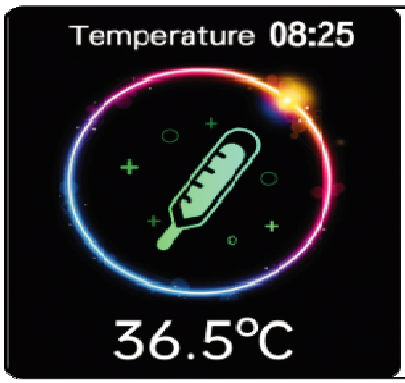

Temperatura corporal


Mudar para a interface de teste de temperatura para ter acesso à detecção de temperatura em tempo real, os dados de monitorização podem ser actualizados para o APP de forma síncrona, e há um relatório de teste.

Nota: Ao testar a temperatura corporal, o sensor de temperatura deve estar em contacto total com a pele (testado após 10 minutos de uso). O teste de temperatura corporal será afectado pela diferença de temperatura do ambiente, servindo apenas como um aviso de aviso.
Para detalhes, consultar o equipamento profissional médico e o diagnóstico médico.




Estado

Veja o número de passos que dá, a distância que caminha, e as calorias que queima a qualquer hora do dia. Pode verificar os seus dados de movimento no APP de forma atempada.

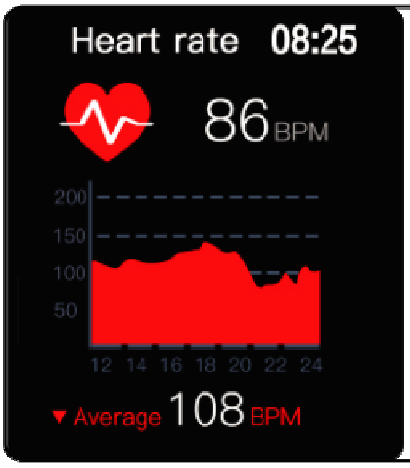

HeartRate

Mudar para a interface de teste do ritmo cardíaco para monitorização do ritmo cardíaco em tempo real, os dados podem ser actualizados para o APP de forma síncrona, e existe um relatório de teste.

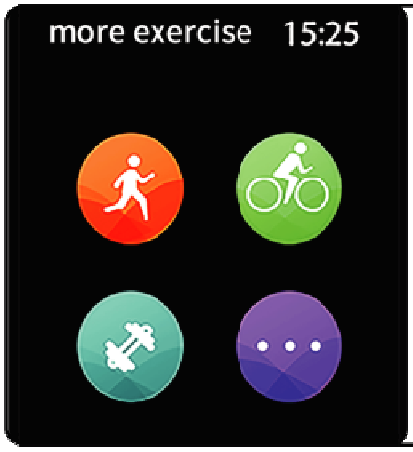


Tensão arterial

Mudar para a interface de pressão arterial para monitorização da pressão arterial em tempo real, os dados podem ser actualizados para o APP de forma síncrona, e há um relatório.



Multi-desportivo

Clique no ícone multi-moção para entrar na selecção do Modo Desportivo, com uma variedade de modos de movimento à escolha.

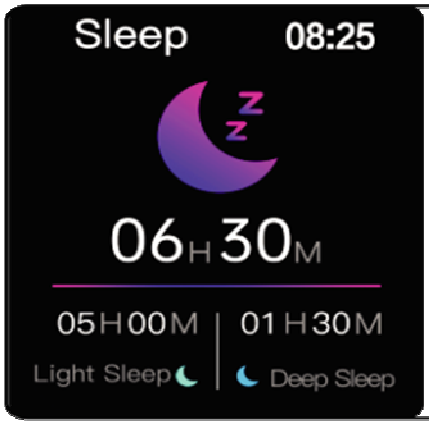

Dormir


O seu relógio pode registar e mostrar a quantidade total de sono que teve ontem à noite, bem como a duração do seu sono profundo e sono leve. Análises mais detalhadas e registos de dados podem ser visualizados no cliente.

Nota: Só quando usar a bracelete para adormecer é que haverá dados de sono.




Clima

A página do tempo mostrará a informação actual sobre o tempo e a qualidade do ar. A informação meteorológica precisa de ser ligada ao cliente para obter dados. Se a ligação for desligada durante muito tempo, a informação meteorológica não será actualizada.
Nota: Não existe interface meteorológica antes da bracelete ser ligada ao APP. Depois de ligar o APP há uma interface meteorológica, o telefone precisa de abrir o posicionamento.

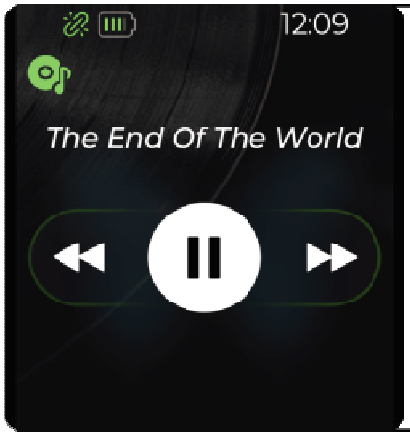


Música

Enquanto ligado, o relógio pode controlar o leitor de música do telefone.

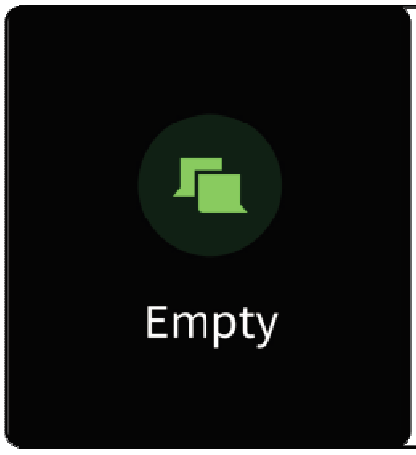

Informação

O relógio pode receber empurrões de notificação que aparecem no telefone, e pode definir itens de empurrar para desligar no cliente. Desloque-se para cima na interface principal para chegar ao mundo das mensagens.

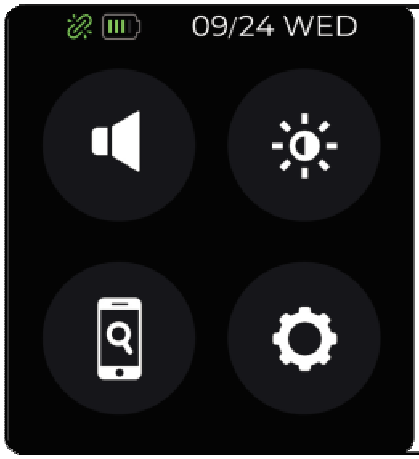

Outras características


Desloque-se para baixo na interface principal para introduzir o limite da função de atalho, pode seleccionar as definições "find mobile phone", "don't disturb on", "brightness adjustment" e outras opções, clique no ícone para introduzir a função correspondente.



Os interruptores de marcação

Manter premida a página de marcação, ir para o botão de marcação, ou mudar a marcação na página de definições. Pode personalizar o mostrador, escolhendo as suas próprias imagens.


Outras funções
Prima para entrar na página do menu inferior para mais operações.



Página de ajuste de luminosidade
Na página de ajuste de brilho, clicar no "+" ou "-" para ajustar o brilho do ecrã.



Informação
MAC ID, informação sobre a versão de firmware de vigilância.



Página de restauro
Na página de restauração da pulseira, prima a tecla de toque para restaurar a pulseira.



Página de encerramento
Na página de encerramento, premir o botão de toque para desligar o aparelho.



LIVOO
Feel good moments

Manual de instrução

PRECAUÇÕES

1. Não use um adaptador com uma corrente sobre 2A. Tempo de carregamento é cerca de 2~3 horas
2. Não carregue após o dispositivo tiver sido danificado pela água
3. Este é um produto de monitoramento eletrónico, os dados recebidos dele não podem ser usados como base médica.
4. Dica de teste de pressão sanguínea:
a) Mantenha seu corpo relaxado e ainda parado enquanto testando.
b) Mantenha o dispositivo na mesma altura que o seu coração, e não fale enquanto você está testando.

Advertência: este produto não é um dispositivo médico. A banda inteligente e suas aplicações não devem ser usadas em diagnóstico, tratamento como um tratamento preventivo para doenças e enfermidades. Consulte os profissionais médicos antes de alterar o hábito de exercício ou hábito de dormir para evitar lesões graves. O fabricante reserva o direito de modificar e aprimorar qualquer descrição das funções neste guia de usuário e atualização contínua do novo conteúdo sem aviso adicional. Este guia de usuário é apenas para referência, a banda inteligente para vender está sujeita ao produto final.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declaramos neste documento sob a nossa responsabilidade exclusiva, que o equipamento de rádio
Relógio inteligente
TEC615 (Faixa de frequência 2402MHz~2480MHz)
cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU
Os seguintes padrões foram aplicados:

Rádio:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)
CEM:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Saúde e segurança:
EN 62368-1 :2020
SAR : EN 50663:2017
Mundolsheim, 23/08/2021

LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding

Smartwatch



Referentie: TEC615
Versie: 1.6
Taal: Nederlands

WWW.LIVOO.FR


LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Let op!
Alvorens u de armband voor de eerste keer in gebruik gaat nemen, moet het worden opgeladen en geactiveerd. Gebruik de uitgeruste magnetische oplader om naar de metalen punt aan de achterkant van de armband te trekken. Het andere uiteinde van de oplader kan worden aangesloten op het USB-oplaadpunt of de USB-interface van de computer.

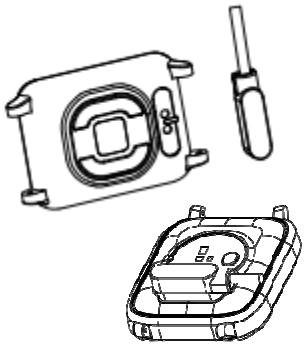


1. Gebruik geen adapter met een stroomsterkte van meer dan 2A. De oplaadtijd is ongeveer 2-3 uur.
2. Niet gaan opladen nadat het apparaat met water was beschadigd.
3. Dit is een elektronisch bewakingsproduct en de ontvangen gegevens kunnen niet als medische basis worden gebruikt.
4. Punt voor bloeddrukmeting:
a) Houd uw lichaam ontspannen en stil tijdens het testen.
b) Houd het apparaat op dezelfde hoogte als uw hart, en praat niet tijdens het testen.
5. Een oplaadomgeving hoger dan 50 graden kan oververhitting en vervorming van de apparatuur veroorzaken.
6. Dit apparaat maakt gebruik van een geïntegreerde batterij. Het is verboden hetzelf te ontmantelen. Gaarne niet te laten vallen, botsen, knijpen, doorboren of snijden.
7. Wanneer de batterij is gebroken of lekt, moet u contact met de ogen en de huid vermijden. Als de situatie zich voordoet, aarzel dan niet de contactpunten aan te raken en onmiddellijk te spoelen met water.


Waarschuwing:
Dit product is geen medisch apparaat. De horloges en hun toepassingen mogen niet worden gebruikt voor diagnose, behandeling of preventie van ziekten of aandoeningen. Om uw gewoonten, zoals lichaamsbeweging en slaap te veranderen, raadpleegt u een gekwalificeerde medische professional om ernstig letsel te voorkomen. We behouden ons het recht voor om alle functies die in deze handleiding worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verbeteren en voortdurend de inhoud over
het product bij te werken. Alle inhoud is onderworpen aan het eigenlijke product.

LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding

INLEIDING VAN DE COMPONENTEN



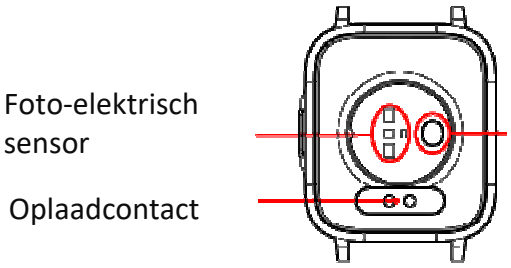

DOWNLOADEN EN KOPPELEN

1. Druk lang op de Aan-/uitknop om in te schakelen.
2. Scan de volgende QR code en installeer de APP of download "GloryFit" App van App store of Google play, Android door te zoeken naar "Gloryfit".

Android iOS Google Play

Compatibiliteitssysteem: Android 4.4 en hoger; IOS 8.0 en hoger. Bluetooth 4.0 wordt ondersteund.


- ✓ Stap 1: Open het mobiele apparaat om persoonlijke informatie in te stellen
- ✓ Stap 2: Ga naar de pagina “Device” [apparaat] en klik op het koppelen van het apparaat
- ✓ Stap 3 : Klik op uw apparaat in de lijst met gescande apparaten
- ✓ Stap 4 : Het koppelen is voltooid

LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding


FUNCTIES INTERFACE

Druk vanuit het hoofdscherm kort op de aanraaktoets om over te schakelen naar de verschillende interfaces.

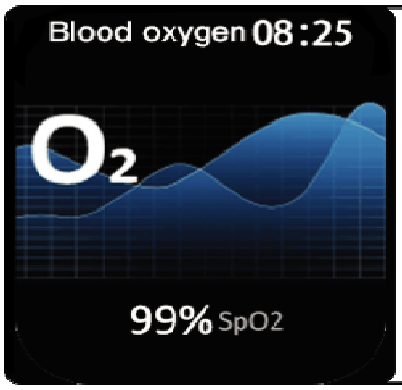

Bloed Zuurstof

Schakel de bloedzuurstoftestinterface om de bloedzuurstofopsporing in real time in te voeren, de controlegegevens kunnen synchroon naar de APP worden bijgewerkt, en er is een testrapport.

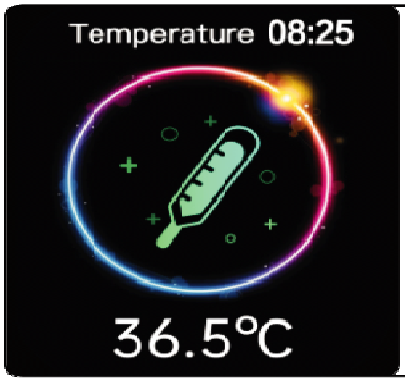

Lichaamstemperatuur


Schakel over naar de temperatuurtest interface om toegang te krijgen tot real-time temperatuurdetectie, de monitoring gegevens kunnen synchroon worden bijgewerkt naar de APP, en er is een testrapport.

Opmerking: Bij het testen van de lichaamstemperatuur moet de temperatuursensor volledig in contact zijn met de huid (getest na 10 minuten dragen). De lichaamstemperatuurtest zal worden beïnvloed door het temperatuurverschil van de omgeving, hij dient alleen als waarschuwingsherinnering.
Voor details, gelieve te verwijzen naar medische professionele apparatuur en doktersdiagnose.




Staat

Bekijk het aantal stappen dat u loopt, de afstand die u loopt en de calorieën die u verbrandt op elk moment van de dag. U kunt uw bewegingsgegevens in de APP tijdig controleren.

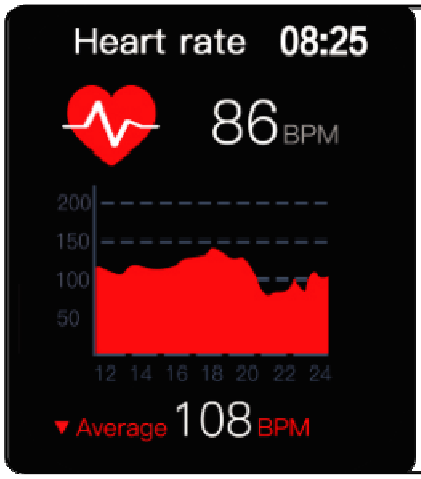

Hartslag

Schakel over naar de hartslagtestinterface voor real-time hartslagmonitoring, de gegevens kunnen synchroon naar de APP worden geüpdatet, en er is een testrapport.

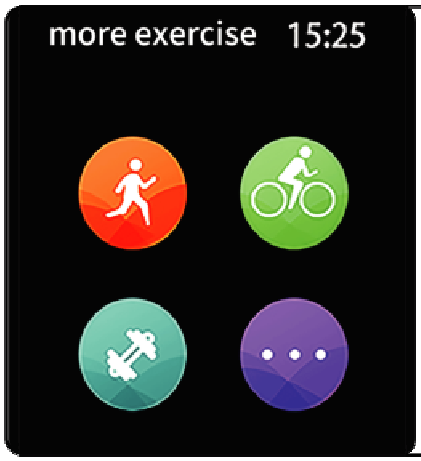


Bloeddruk

Schakel over naar de bloeddrukinterface voor real-time monitoring van de bloeddruk, de gegevens kunnen synchroon worden bijgewerkt naar de APP, en er is een rapport.



Multi-sport

Klik op het multi-motion icoon om de Sport Mode selectie te openen, met een verscheidenheid aan bewegingsmodi om uit te kiezen.

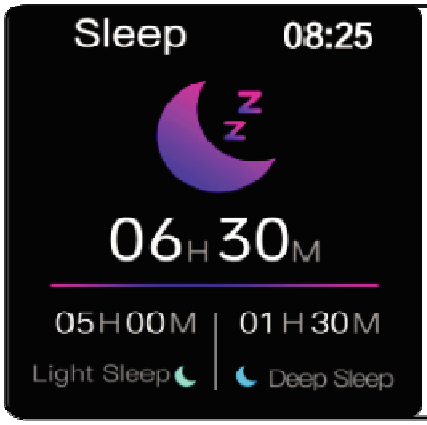

Slaap


Uw horloge kan de totale hoeveelheid slaap die u de afgelopen nacht hebt gehad registreren en tonen, evenals de duur van uw diepe slaap en lichte slaap. Meer gedetailleerde analyses en gegevensrecords kunnen in de client worden bekeken.

Opmerking: Alleen wanneer u de armband draagt om in slaap te vallen, zullen er slaapgegevens zijn.




Weer

De weerpagina toont de huidige weer- en luchtkwaliteitsinformatie. De weerinformatie moet verbonden zijn met de client om gegevens te verkrijgen. Als de verbinding voor een lange tijd wordt verbroken, zal de weerinformatie niet worden bijgewerkt. Opmerking: Er is geen weer-interface voordat de armband is verbonden met de APP. Na het aansluiten van de APP is er een weer inter face, de telefoon

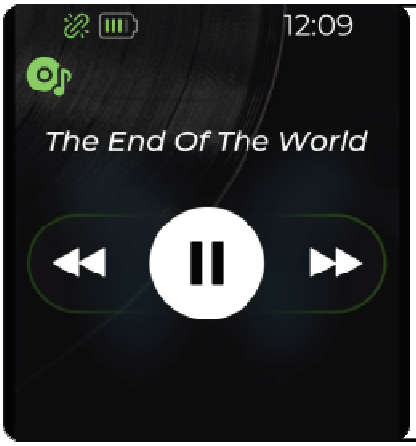


Muziek

Als het horloge verbonden is, kan het de muziekspeler van de telefoon bedienen.

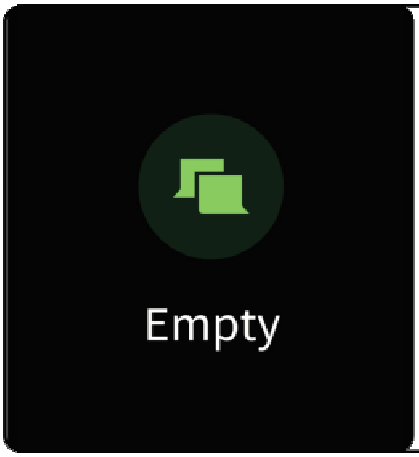

Informatie

Het horloge kan pushmeldingen ontvangen die op de telefoon worden weergegeven, en u kunt instellen dat pushberichten worden uitgeschakeld in de client. Veeg omhoog in de hoofdinterface om naar de berichtenwereld te gaan.

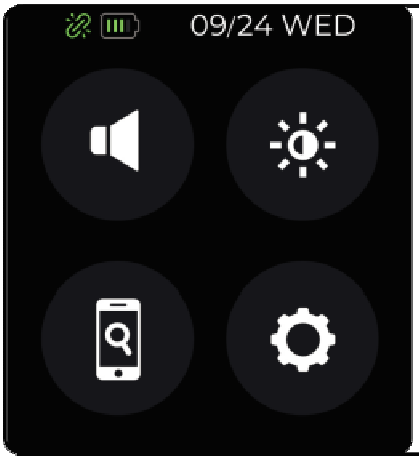

Andere functies

Veeg naar beneden in de hoofdinterface om de snelkoppelingsfunctie te openen, u kunt de "mobiele telefoon vinden", "niet storen aan", "helderheid aanpassen" instellingen en andere opties selecteren, klik op het pictogram om de bijbehorende functie te openen.



De wijzerplaatschakelaars

Druk op de wijzerplaatpagina en houd deze ingedrukt, ga naar de wijzerplaatschakelaar, of schakel de wijzerplaat op de instellingenpagina. U kunt de instelknop aanpassen door uw eigen foto's te kiezen.

Andere functies

Druk op om naar de onderste menupagina te gaan voor meer handelingen




Helderheidsaanpassingspagina

Op de helderheidsaanpassingspagina klikt u op de "+" of "-" om de helderheid van het scherm aan te passen.



Informatie

MAC ID, informatie over de firmwareversie van het horloge.



Pagina herstellen

Op de herstelpagina voor de armband drukt u op de aanraaktoets om de armband te herstellen.



Uitschakelpagina

Op de uitschakelpagina drukt u op de aanraaktoets om het toestel uit te schakelen.



VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik geen adapter met een stroomsterkte van meer dan 2A. De oplaadtijd is ongeveer 2-3 uur
2. Niet gaan opladen nadat het apparaat met water was beschadigd.
3. Dit is een elektronisch bewakingsproduct en de ontvangen gegevens kunnen niet als medische basis worden gebruikt.
4. Punt voor bloeddrukmeting:
a) Houd uw lichaam ontspannen en stil tijdens het testen.
b) Houd het apparaat op dezelfde hoogte als uw hart, en praat niet tijdens het testen.

Waarschuwing: dit product is geen medisch apparaat. De Smart-band en de toepassingen ervan mogen niet worden gebruikt voor diagnose, en een preventieve behandeling voor ziekten en aandoeningen. Raadpleeg medische professionals vóór u uw trainings- of slaapgewoonten verandert om ernstig letsel te voorkomen. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de beschrijving van functies in deze gebruikershandleiding en continue bijwerken van de nieuwe inhoud zonder verdere kennisgeving te wijzigen en te verbeteren. Deze gebruikershandleiding is uitsluitend ter referentie, de Smart-band voor verkoop is onderworpen aan het eindproduct.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaren hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de radioapparatuur

Smartwatch
TEC615 (Frequentiebereik 2402MHz~2480MHz)

Voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 2014/53/EG

De volgende normen zijn toegepast:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.3 (2019-07)

EMC:
ETSI EN301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.0 (2019-03)

Gezondheid en veiligheid:

LIVOO
Feel good moments

Gebruikershandleiding

EN 62368-1 :2020

SAR : EN 50663:2017

Mundolsheim, 23/08/2021



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.
Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.
Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving